

Composito bic-attivo autopolimerizzante

**DESCRIZIONE**

Resina composta bi-componente in cartuccia autoisolecabile per la preparazione di provvisori.

**COMPOSIZIONE**: Esteri metallici multifunzionali

**CAMPI D'IMPIEGO / INDICAZIONI**
Preparazione diretta o indiretta di corone e ponti provvisori. Restaui temporanei per inlay e onlay.

**VANTAGGI**

Non contiene metil-metacrilato. La temperatura sviluppata durante la polimerizzazione è inferiore a 40°C (104°F) quindi protegge le preparazioni senza causare disagio al paziente. Manifesta ottima resistenza ai carichi, all'abrasione ed eccellente stabilità dimensionale. Il risultato estetico è garantito dalla brillantezza e dalla stabilità dei colori. In caso di rottura accidentale, **Acrytemp** è semplice da riparare. È possibile impiegare un qualsiasi composto auto o foto polimerizzabile per ristabilire un perfetto legame con il substrato.

**Acrytemp** è preciso e permette di ottenere bordi estremamente sottili. Per la sua flessibilità, i ponti a travata lunga sono particolarmente resistenti. Il sistema in cartuccia consente un'ottima miscelazione ottimale e priva di bolle, portandoci al prodotto finito in un modo diretto e veramente dimensionale (metodo diretto) o sulla mascherina (metodo indiretto).

**MOD' D'USO**
**PRESA D'IMPRESA**

Prima della preparazione dei monconi, prendere un'impresita in silicone o alginato. Come un strumento franchant (grat. Putty Cut) rimuovere le zone interdentali ed i contorni suttoquadrati, in modo da poter riproporzionare l'impresita nel caso orale. Nel quadranti posteriori, in caso di mancanza di un elemento, praticare un solco nell'impresita facendo in modo da creare una connessione a "barra T", id est.

Proseguire quindi con le normali procedure di studio (preparazione dei monconi, modellazione). Nel caso venga praticato il metodo indiretto, sviluppare il modello come di consueto.

**DISPENSER E CARTUCCIA**

Ritirare la cremagliera del dispenser fino a inizio corsa agendo sulla levetta nera situata al dritto della stessa.

Insediare il pistone. Collocare correttamente la cartuccia nel dispenser (il rapporto di miscelazione è 4:1).

L'usario inserimento deve permettere al lobo cartuccia di chiudere senza difficoltà.

**OSSERVAZIONI IMPORTANTI:** La consulenza linguistica verbalmente, per iscritto o attraverso dimostrazioni, sull'uso dei nostri prodotti, si basa sullo stato attuale della tecnica odontoiatrica e del nostro know how. Essa è considerata come un'informazione non impegnativa, anche in relazione ad eventuali diritti di terzi, e non esime l'operatore professionale da controllare personalmente se il prodotto è idoneo all'applicazione prevista. L'utilizzo e l'applicazione da parte dell'operatore professionale avviene senza possibilità di controllo da parte dell'Azienda e pertanto sottoannala alla responsabilità dell'operatore professionale. Un'eventuale responsabilità di danni si limita al valore della merce fornita dall'Azienda e utilizzata dall'operatore professionale.

**SOLO PER USO DENTALE**

**acrytemp** **(800-819083)** **NOTICE D'UTILISATION (FR)**

Resine composite bi-acrylique autopolimerisante

**DESCRIPTION**
Resine composite bi-composant en cartouche autoamalgéable pour la préparation d'outils provisoires

**COMPOSITION**
Esters métalliques multifonctions

**DOMAINES D'UTILISATION / INDICATION**
Préparation directe ou indirecte de couronnes et de ponts provisoires. Restauroations provisoires pour inlay et onlay.

Cette résine ne contient pas de méthacrylate de méthyle . La température développée au cours de la polymérisation est inférieure à 40°C (104°F), ce qui lui permet de protéger la préparation sans gêner le patient. Cette résine a une très bonne résistance aux chocs, une excellente stabilité dimensionnelle.

Le résultat esthétique est garanti par la brillance et la stabilité des couleurs. En cas de rupture accidentelle, **Acrytemp** se repare facilement. On peut utiliser n'importe quel produit composite auto ou photo-polymérisable pour rétablir un lien de continuité avec le substrat.

**Acrytemp** est précis et permet d'obtenir des bords extrêmement minces. Grâce à sa flexibilité, les bridges à longue travée sont particulièrement résistants.

**MODE D'EMPLOI**
Le système en cartouche permet un mélange optimal et sans bulles, offrant la possibilité d'appliquer le produit directement sur l'empreinte (méthode directe) ou sur la matrice (méthode indirecte).

**PRISE D'EMPREINTE**
Avant la préparation des moignons, prendre une empreinte en silicone ou alginat. Comme un instrument franchant (grat. Putty Cut) enlever les zones interdentali et les contres-dépouilles afin de pouvoir repositionner facilement l'empreinte dans la cavité orale. Dans les quadrants postérieurs, en cas d'absence d'un élément, préparer un sillonn qui permettra de créer une connexion a "barra T", id est.

Poursuivre ensuite avec les procédures normales au cabinet (préparation des moignons, extraction, etc.). En cas d'utilisation de la méthode indirecte, développer le modèle comme d'habitude.

**DISTRIBUTEUR ET CARTUCCIA**
Retirare la cremagliera del distributore jusqu'au début de course en agissant sur le petit levier noir placé au-dessous.

Soulever le dispositif de blocage permetant. Placer correctement la cartouche dans le logement prévu à cet effet.

L'introduction exacte doit permettre la fermeture facile du dispositif de blocage et de la cartouche.

**OBSERVATIONS IMPORTANTES:** Les indications fournies de manière verbale, par écrit ou à travers ds démonstrations portées sur l'utilisation de nos produits se basent sur l'état actuel de la technique odontologique et de notre savoir-faire. Elles doivent être considérées comme ds informations fournies sans engagement, et ne en ce concerne les éventuels droits de tiers, et n'exonèrent pas l'utilisateur de l'obligation de contrôler personnellement si le produit est adéquat pour l'application qu'a été prévue. L'utilisation et l'application de la part de l'utilisateur se font sans possibilité de contrôle de la part de la firme, et, par conséquent, celle-ci n'est pas responsable de l'utilisation. Une éventuelle responsabilité raisonne de dommages est limitée à la valeur de la marchandise fournie par la firme.

**acrytemp** **GERBRAUCHSINFORMATION (DE)**

Diacyrlgemisch Selbstpolymerisierendes

**BESCHREIBUNG**
Zweikomponenten-Verbundharz in selbstschmelzender Kartusche zur Anfertigung von Provisoren.

**ZUSAMMENSETZUNG:** Multifunktionale-Metacryl-Esterharze

**ANWENDUNGSBEREICH UND HINWEISE**
Direkte oder indirekte Anfertigung provisorischer Kronen und Brücken, provisorische Wiederherstellung bei In- und Onlays.

**VORZÜGE**
Enthält kein Methyl-Metacrylat. Die während des Polymerisierens erzielte Temperatur liegt unter 40° C (104°F), das angefertigte Teil wird somit ohne Unannehmlichkeiten für den Patienten geschützt.

Das Prozedere ermöglicht eine optimale Belastungs- und Verschleißfestigkeit sowie eine ausgezeichnete Maßbeständigkeit.

Das ästhetische Ergebnis ist durch die kräftigen und beständigen Farben gewährleistet. Die Farbe des unbearbeiteten Bruchs lässt sich **Acrytemp** auf äußerst einfache Weise reparieren, es besteht die Möglichkeit, zum Wiederherstellen einer perfekten chemischen Verbindung, jede Art von auto- oder foto-polymersierbarem Gemisch anzuwenden.

**Acrytemp** ermöglicht Präzision und das Erzielen einer dünner Ränder. **Acrytemp** ist dank seiner Flexibilität besonders widerstandsfähig.

**GERÄUCH**
Das System in Kartuschen gewährleistet eine optimale Selbstmischung ohne Blasenbildung, wodurch das Produkt direkt in den Abformlötl (direkte Technik) oder in der Matrix (indirekte Technik) appliziert werden kann.

**ABDRUCKNAHME**
Vor der Stumpfräparatur ist zunächst eine Abformung mit Silikon oder Alginat vorzunehmen. Mit einem scharfen Instrument (z.B. Putty Cut) die Interdentaltbereiche und die Unterschnitte entfernen, damit der Abdruck leicht in den Mund eingebracht werden kann. In den hinteren Quadranten eine Lücke ausfüllen, ist ein Abdruck eine Rille auszuführen, um zwischen den Zähnen eine Stangenverbindung zu schaffen. Anschließend die normale Präparatierarbeiten wiedernehmen (Präparieren der Stümpfe, Extraktion, usw.).

**SPENDER UND KARTUSCHEN**
Die Zahnstange des Spenders bis zum Hübbeginn ziehen und die schwarze Lasche unter der Zahnstange abheben.

Die Kartuschen-Arretierung einbauen. Die Kartusche korrekt in den Spender einsetzen (siehe Abbildung 4:1).

Bei einem korrekten Einsetzen sollte sich die Kartuschen-Arretierung problemlos ablesen lassen.

**WICHTIGE HINWEISE:** Eine mündlich, schriftlich oder mittels Vorführungen erfolgte Beratung hinsichtlich der Verwendung unserer Produkte gründet auf dem gegenwärtigen Stand der zahnärztlichen Technik und unserem Wissen. Es handelt sich hierbei um eine nicht verbindliche Information, auch hinsichtlich eventueller Rechte eines Dritten, die in keiner Weise den Benutzer davon befreit, persönlich die Eignung des Gerätes für die vorgesehene Anwendung zu überprüfen. Gebrauch und Anwendung durch den Benutzer erfolgen ohne jegliche Möglichkeit einer Kontrolle durch die Firma und liegen somit in der Verantwortung des Benutzers. Eine eventuelle Schadenshaftung beschränkt sich auf den Wert der von der Firma gelieferten und vom Benutzer verwendeten Ware.

**acrytemp** **GERBUKSAANWIJZING (NL)**

Zelfpolymeriserend biacryl composit

**BESCHRIJVING**
Tweecomponenten composietharz in zelfsmeltende patroon voor het prepareren van noodoplossingen.

**SAMENSTELLING**
Multifunctionele methacrylaats

**TOEPASSINGSGEBIEDEN / INDICATIES**
Direct of indirect prepareren van tijdelijke kronen en bruggen. Tijdelijke reparaties voor inlay's en onlays.

**VOORDELEN**
Bevat geen methylnietacrylaat. De temperatuur die tijdens de polymerisatie ontbield wordt is lager dan 40°C (104°F) en beschermd op de manier de preparaten zonder ongemakken voor de patiënt. Heeft een uitstekende belastingsbestendigheid en schuwaandemie en een uitstekende dimensionale stabiliteit.

De afwerking maakt het mogelijk tegevoelbaar door de glans en de stabiliteit van de kleuren. In geval van overhoofde breuk is **Acrytemp** makkelijk te repareren. Er kan elk willekeurig zelfpolymeriseerbaar of fotopolymeriseerbaar composit gebruikt worden om weer een perfecte verbinding te krijgen.

**Acrytemp** is nauwkeurig en biedt de mogelijkheid om uitstekend dunne randen te krijgen. Dankzij de buigzaamheid ervan zijn bruggen met lange overspanningen bijzonder stevig.

**GERBUKSAANWIJZING**
Het patroonvezelmoede systeem een optimale dosering zonder luchtbollen mogelijk zodat het product gemakkelijk in de afdruk (directe methode) of op de mal (indirecte methode) aangebracht kan worden.

**NEMEN VAN AFDRUKKEN**
Alvorens de tandstempels te prepareren, een afdruk met silicone of alginat nemen. Met een scharp instrument (bijv. Putty Cut) de interdentale gebieden en eventuele onderdunten verwijderen, zodat de afdruk op eenvoudige wijze in de mondholte aangebracht kan worden. Te hoogte van de achterste kiezen, indien er een element ontbreekt, een groef in de afdruk maken zodat er een "staafverbinding" tussen de tanden ontbreekt wordt.
In de achterste quadranten een lichte uitsparing maken om tussen de tanden een stangenverbinding te schaffen.
Aansluitend de normale preparatiearbeid weer opnemen (Präparieren der Stümpfe, Extraktion, usw.).

**SPENDER EN KARTUSCHEN**
De Zahnstange des Spenders bis zum Hübbeginn ziehen und die schwarze Lasche unter der Zahnstange abheben.

Die Kartuschen-Arretierung einbauen. Die Kartusche korrekt in den Spender einsetzen (siehe Abbildung 4:1).

Bei einem korrekten Einsetzen sollte sich die Kartuschen-Arretierung problemlos ablesen lassen.

**WICHTIGE HINWEISE:** Eine mündlich, schriftlich oder mittels Vorführungen erfolgte Beratung hinsichtlich der Verwendung unserer Produkte gründet auf dem gegenwärtigen Stand der zahnärztlichen Technik und unserem Wissen. Es handelt sich hierbei um eine nicht verbindliche Information, auch hinsichtlich eventueller Rechte eines Dritten, die in keiner Weise den Benutzer davon befreit, persönlich die Eignung des Gerätes für die vorgesehene Anwendung zu überprüfen. Gebrauch und Anwendung durch den Benutzer erfolgen ohne jegliche Möglichkeit einer Kontrolle durch die Firma und liegen somit in der Verantwortung des Benutzers. Eine eventuelle Schadenshaftung beschränkt sich auf den Wert der von der Firma gelieferten und vom Benutzer verwendeten Ware.

**acrytemp** **GERBUKSAANWIJZING (NL)**

Zelfpolymeriserend biacryl composit

**BESCHRIJVING**
Tweecomponenten composietharz in zelfsmeltende patroon voor het prepareren van noodoplossingen.

**SAMENSTELLING**
Multifunctionele methacrylaats

**TOEPASSINGSGEBIEDEN / INDICATIES**
Direct of indirect prepareren van tijdelijke kronen en bruggen. Tijdelijke reparaties voor inlay's en onlays.

**VOORDELEN**
Bevat geen methylnietacrylaat. De temperatuur die tijdens de polymerisatie ontbield wordt is lager dan 40°C (104°F) en beschermd op de manier de preparaten zonder ongemakken voor de patiënt. Heeft een uitstekende belastingsbestendigheid en een schuwaandemie en een uitstekende dimensionale stabiliteit.

De afwerking maakt het mogelijk tegevoelbaar door de glans en de stabiliteit van de kleuren. In geval van overhoofde breuk is **Acrytemp** makkelijk te repareren. Er kan elk willekeurig zelfpolymeriseerbaar of fotopolymeriseerbaar composit gebruikt worden om weer een perfecte verbinding te krijgen.

**Acrytemp** is nauwkeurig en biedt de mogelijkheid om uitstekend dunne randen te krijgen. Dankzij de buigzaamheid ervan zijn bruggen met lange overspanningen bijzonder stevig.

**GERBUKSAANWIJZING**
Het patroonvezelmoede systeem een optimale dosering zonder luchtbollen mogelijk zodat het product gemakkelijk in de afdruk (directe methode) of op de mal (indirecte methode) aangebracht kan worden.

**NEMEN VAN AFDRUKKEN**
Alvorens de tandstempels te prepareren, een afdruk met silicone of alginat nemen. Met een scharp instrument (bijv. Putty Cut) de interdentale gebieden en eventuele onderdunten verwijderen, zodat de afdruk op eenvoudige wijze in de mondholte aangebracht kan worden. Te hoogte van de achterste kiezen, indien er een element ontbreekt, een groef in de afdruk maken zodat er een "staafverbinding" tussen de tanden ontbreekt wordt.
In de achterste quadranten een lichte uitsparing maken om tussen de tanden een stangenverbinding te schaffen.
Aansluitend de normale preparatiearbeid weer opnemen (Präparieren der Stümpfe, Extraktion, usw.).

**SPENDER EN KARTUSCHEN**
De Zahnstange des Spenders bis zum Hübbeginn ziehen und die schwarze Lasche unter der Zahnstange abheben.

Die Kartuschen-Arretierung einbauen. Die Kartusche korrekt in den Spender einsetzen (siehe Abbildung 4:1).

Bei einem korrekten Einsetzen sollte sich die Kartuschen-Arretierung problemlos ablesen lassen.

**WICHTIGE HINWEISE:** Eine mündlich, schriftlich oder mittels Vorführungen erfolgte Beratung hinsichtlich der Verwendung unserer Produkte gründet auf dem gegenwärtigen Stand der zahnärztlichen Technik und unserem Wissen. Es handelt sich hierbei um eine nicht bindende informatie, ook met betrekking tot eventuele rechten van derden, en met onthefte de gebruiker niet van het persoonlijk controleren of het product geschikt is voor de voorgezede toepassing. Eventuele verantwoordelijkheid voor schade is gelimiteerd tot de waarde van de goederen die door de firma zijn geleverd en door de gebruiker zijn gebouwd.

**acrytemp** **Τρόπος Χρήσης (EL)**

Σύνθετο διακυτταρικό αυτοπολυμεριζόμενο

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**
Resina composta bi-componente in cartuccia autoisolecabile per la preparazione di provvisori autoattiva.

**ΣΥΝΘΕΣΗ**
Metacrilato esterato multifunzionali

**ΠΕΛΕΘ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**
Preparazione diretta o indiretta di corone e ponti provvisori. Restauroazioni provisoires per inlay e onlay.

**ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ**
Non contiene metil-metacrilato. La temperatura sviluppata durante la polimerizzazione è inferiore a 40°C (104°F) quindi protegge le preparazioni senza causare disagio al paziente. Manifesta ottima resistenza ai carichi, all'abrasione ed eccellente stabilità dimensionale. Il risultato estetico è garantito dalla brillantezza e dalla stabilità dei colori. In caso di rottura accidentale, **Acrytemp** è semplice da riparare. È possibile impiegare un qualsiasi composto auto o foto polimerizzabile per ristabilire un perfetto legame con il substrato.

**MOD' D'USO**
**PRESA D'IMPRESA**
Prima della preparazione dei monconi, prendere un'impresita in silicone o alginato. Come un strumento franchant (grat. Putty Cut) rimuovere le zone interdentali ed i contorni suttoquadrati, in modo da poter riproporzionare l'impresita nel caso orale. Nel quadranti posteriori, in caso di mancanza di un elemento, praticare un solco nell'impresita facendo in modo da creare una connessione a "barra T", id est.

Proseguire quindi con le normali procedure di studio (preparazione dei monconi, modellazione). Nel caso venga praticato il metodo indiretto, sviluppare il modello come di consueto.

**DISTRIBUTEUR ET CARTUCCIA**
Retirare la cremagliera del distributore jusqu'au début de course en agissant sur le petit levier noir placé au-dessous.

Soulever le dispositif de blocage permettant. Placer correctement la cartouche dans le logement prévu à cet effet.

L'introduction exacte doit permettre la fermeture facile du dispositif de blocage et de la cartouche.

**OBSERVATIONS IMPORTANTES:** Les indications fournies de manière verbale, par écrit ou à travers ds démonstrations portées sur l'utilisation de nos produits se basent sur l'état actuel de la technique odontologique et de notre savoir-faire. Elles doivent être considérées comme ds informations fournies sans engagement, et ne en ce concerne les éventuels droits de tiers, et n'exonèrent pas l'utilisateur de l'obligation de contrôler personnellement si le produit est adéquat pour l'application qu'a été prévue. L'utilisation et l'application de la part de l'utilisateur se font sans possibilité de contrôle de la part de la firme, et, par conséquent, celle-ci n'est pas responsable de l'utilisation. Une éventuelle responsabilité raisonne de dommages est limitée à la valeur de la marchandise fournie par la firme.

**acrytemp** **GERBUKSAANWIJZING (NL)**

Zelfpolymeriserend biacryl composit

**BESCHRIJVING**
Tweecomponenten composietharz in zelfsmeltende patroon voor het prepareren van noodoplossingen.

**SAMENSTELLING**
Multifunctionele methacrylaats

**TOEPASSINGSGEBIEDEN / INDICATIES**
Direct of indirect prepareren van tijdelijke kronen en bruggen. Tijdelijke reparaties voor inlay's en onlays.

**VOORDELEN**
Bevat geen methylnietacrylaat. De temperatuur die tijdens de polymerisatie ontbield wordt is lager dan 40° C (104°F), dat angefertigte deel wordt zo gemaakt dat het niet ongemakkelijk is voor de patiënt. Het heeft een uitstekende belastingsbestendigheid en een uitstekende dimensionale stabiliteit.

De afwerking maakt het mogelijk tegevoelbaar door de glans en de stabiliteit van de kleuren. In geval van overhoofde breuk is **Acrytemp** makkelijk te repareren. Er kan elk willekeurig zelfpolymeriseerbaar of fotopolymeriseerbaar composit gebruikt worden om weer een perfecte verbinding te krijgen.

**Acrytemp** is nauwkeurig en biedt de mogelijkheid om uitstekend dunne randen te krijgen. Dankzij de buigzaamheid ervan zijn bruggen met lange overspanningen bijzonder stevig.

**GERBUKSAANWIJZING**
Het patroonvezelmoede systeem een optimale dosering zonder luchtbollen mogelijk zodat het product gemakkelijk in de afdruk (directe methode) of op de mal (indirecte methode) aangebracht kan worden.

**NEMEN VAN AFDRUKKEN**
Alvorens de tandstempels te prepareren, een afdruk met silicone of alginat nemen. Met een scharp instrument (bijv. Putty Cut) de interdentale gebieden en eventuele onderdunten verwijderen, zodat de afdruk op eenvoudige wijze in de mondholte aangebracht kan worden. Te hoogte van de achterste kiezen, indien er een element ontbreekt, een groef in de afdruk maken zodat er een "staafverbinding" tussen de tanden ontbreekt wordt.
In de achterste quadranten een lichte uitsparing maken om tussen de tanden een stangenverbinding te schaffen.
Aansluitend de normale preparatiearbeid weer opnemen (Präparieren der Stümpfe, Extraktion, usw.).

**SPENDER EN KARTUSCHEN**
De Zahnstange des Spenders bis zum Hübbeginn ziehen und die schwarze Lasche unter der Zahnstange abheben.

Die Kartuschen-Arretierung einbauen. Die Kartusche korrekt in den Spender einsetzen (siehe Abbildung 4:1).

Bei einem korrekten Einsetzen sollte sich die Kartuschen-Arretierung problemlos ablesen lassen.

**WICHTIGE HINWEISE:** Eine mündlich, schriftlich oder mittels Vorführungen erfolgte Beratung hinsichtlich der Verwendung unserer Produkte gründet auf dem gegenwärtigen Stand der zahnärztlichen Technik und unserem Wissen. Es handelt sich hierbei um eine nicht verbindliche Information, auch hinsichtlich eventueller Rechte eines Dritten, die in keiner Weise den Benutzer davon befreit, persönlich die Eignung des Gerätes für die vorgesehene Anwendung zu überprüfen. Gebrauch und Anwendung durch den Benutzer erfolgen ohne jegliche Möglichkeit einer Kontrolle durch die Firma und liegen somit in der Verantwortung des Benutzers. Eine eventuelle Schadenshaftung beschränkt sich auf den Wert der von der Firma gelieferten und vom Benutzer verwendeten Ware.

Tomiglia il tappo colorato. Per un esatto controllo del flusso, estrarre leggermente una minima quantità di prodotto (circa 0,1 g) che i componenti fuoriscano uniformemente. Inserire, pulendo, il materiale eccedente.

Eliminare il puntale miscelatore seguendo la tacca a "V" sulla ghiera colorata. Questa deve coincidere con la corrispondente sede sulla cartuccia. Il dispositivo è pronto pronto per essere utilizzato.

Dopo ogni impiego lasciare il puntale inserito fino al successivo utilizzo. Per ulteriori chiarimenti sul caricamento e l'uso del dispenser, consultare le "Istruzioni Dispenser D2" - Zhermack.

**APPLICAZIONE**
Estrarre una piccola porzione sulla leva del dispenser, applicare **Acrytemp** all'interno dell'impronta precedentemente preparata, pulita ed asciutta. Posizionare la punta della cartuccia micelatrice nella porzione più profonda della impronta lasciandola immersa nel materiale per evitare la formazione di bolle.

**PREPARAZIONE DEI PROVVISORI**
L'impresita deve essere presa in cartuccia di **Acrytemp**, viene quindi ripozionata correttamente in bocca o sul modello.

Dopo 2 - 3 minuti (da 5" (95°F) (in bocca), o 4 - 6 minuti a temp. ambiente 23°C (73,5°F) (sul modello) all'inizio dell'applicazione, **Acrytemp** durante la fase elastica può essere rimossa senza difficoltà.

**Nota importante:** solo rimuovendo il provvisorio durante la fase elastica si eviterà di danneggiarlo.

**INDURIMENTO E FINITURA**
Dopo la rimozione del provvisorio dall'impronta o dalle preparazioni, eliminare il materiale in eccesso ed eventuali sottosquadri. Sarebbe opportuno completare la polimerizzazione ponendo il manufatto in acqua calda a 45-55°C (113-131°F) per 5 minuti, se ciò non fosse possibile, attendere circa 10 minuti dall'inizio dell'applicazione e rifinire utilizzando strumenti rotanti specifici o abrasivi molli fini.

**Nota importante:** l'ossigeno inibisce superficialmente creando una sottile patina che, se non viene rimossa, ostacola la ulteriore polimerizzazione a freddo o in autoclave del dispositivo, attenersi alle istruzioni del fabbricante. Per la disinfezione si consiglia l'utilizzo dello **Zeta 3** (Zhermack), per la sterilizzazione liquida **Zeta 2** (Zhermack).

**DATI TECNICI**

Reporto di miscelazione (Base/Catalyst) 4:1 (automat)
Tempo di lavorazione 1'
Elasticità all'applicazione 35°C (95°F): 2-3 min / 23°C (73,5°F): 4-6 min
Tempo di indurimento 45-55°C (113-131°F): 5 min / 23°C (73,5°F): 10 min
Resistenza alla compressione dopo 24 ore 290 MPa
Resistenza alla flessione dopo 24 ore 60 MPa

**PRESENTAZIONE**
1 Cartuccia da 50 ml (automatik 4:1), disponibile nei colori **A2 - A3 - A3.5**
15 Puntali di miscelazione per automatik 4:1.

**RIPARAZIONI**
Nonostante le ottime caratteristiche di resistenza meccanica, in caso di rottura seguire le seguenti procedure:

1. Rimuovere il provvisorio, utilizzare preferibilmente cemento senza eugenolo. In caso di impiego di cementi contenenti eugenolo, si consideri che tracce o residui di eugenolo possono successivamente creare problemi di inibizione verso composti o altri prodotti soprattutto se a base acrilica.

2. Rimuovere l'ottimo caratteristiche di resistenza meccanica, in caso di rottura seguire le seguenti procedure:

1. Rimuovere il provvisorio, utilizzare preferibilmente cemento senza eugenolo. In caso di impiego di cementi contenenti eugenolo, si consideri che tracce o residui di eugenolo possono successivamente creare problemi di inibizione verso composti o altri prodotti soprattutto se a base acrilica.

2. Rimuovere l'ottimo caratteristiche di resistenza meccanica, in caso di rottura seguire le seguenti procedure:

1. Rimuovere il provvisorio, utilizzare preferibilmente cemento senza eugenolo. In caso di impiego di cementi contenenti eugenolo, si consideri che tracce o residui di eugenolo possono successivamente creare problemi di inibizione verso composti o altri prodotti soprattutto se a base acrilica.

2. Rimuovere l'ottimo caratteristiche di resistenza meccanica, in caso di rottura seguire le seguenti procedure:

1. Rimuovere il provvisorio, utilizzare preferibilmente cemento senza eugenolo. In caso di impiego di cementi contenenti eugenolo, si consideri che tracce o residui di eugenolo possono successivamente creare problemi di inibizione verso composti o altri prodotti soprattutto se a base acrilica.

2. Rimuovere l'ottimo caratteristiche di resistenza meccanica, in caso di rottura seguire le seguenti procedure:

1. Rimuovere il provvisorio, utilizzare preferibilmente cemento senza eugenolo. In caso di impiego di cementi contenenti eugenolo, si consideri che tracce o residui di eugenolo possono successivamente creare problemi di inibizione verso composti o altri prodotti soprattutto se a base acrilica.

2. Rimuovere l'ottimo caratteristiche di resistenza meccanica, in caso di rottura seguire le seguenti procedure:

1. Rimuovere il provvisorio, utilizzare preferibilmente cemento senza eugenolo. In caso di impiego di cementi contenenti eugenolo, si consideri che tracce o residui di eugenolo possono successivamente creare problemi di inibizione verso composti o altri prodotti soprattutto se a base acrilica.

2. Rimuovere l'ottimo caratteristiche di resistenza meccanica, in caso di rottura seguire le seguenti procedure:

1. Rimuovere il provvisorio, utilizzare preferibilmente cemento senza eugenolo. In caso di impiego di cementi contenenti eugenolo, si consideri che tracce o residui di eugenolo possono successivamente creare problemi di inibizione verso composti o altri prodotti soprattutto se a base acrilica.

2. Rimuovere l'ottimo caratteristiche di resistenza meccanica, in caso di rottura seguire le seguenti procedure:

1. Rimuovere il provvisorio, utilizzare preferibilmente cemento senza eugenolo. In caso di impiego di cementi contenenti eugenolo, si consideri che tracce o residui di eugenolo possono successivamente creare problemi di inibizione verso composti o altri prodotti soprattutto se a base acrilica.

2. Rimuovere l'ottimo caratteristiche di resistenza meccanica, in caso di rottura seguire le seguenti procedure:

1. Rimuovere il provvisorio, utilizzare preferibilmente cemento senza eugenolo. In caso di impiego di cementi contenenti eugenolo, si consideri che tracce o residui di eugenolo possono successivamente creare problemi di inibizione verso composti o altri prodotti soprattutto se a base acrilica.

2. Rimuovere l'ottimo caratteristiche di resistenza meccanica, in caso di rottura seguire le seguenti procedure:

1. Rimuovere il provvisorio, utilizzare preferibilmente cemento senza eugenolo. In caso di impiego di cementi contenenti eugenolo, si consideri che tracce o residui di eugenolo possono successivamente creare problemi di inibizione verso composti o altri prodotti soprattutto se a base acrilica.

2. Rimuovere l'ottimo caratteristiche di resistenza meccanica, in caso di rottura seguire le seguenti procedure:


1. Rimuovere il provvisorio, utilizzare preferibilmente cemento senza eugenolo. In caso di impiego di cementi contenenti eugenolo, si consideri che tracce o residui di eugenolo possono successivamente creare problemi di inibizione verso composti o altri prodotti soprattutto se a base acrilica.

2. Rimuovere l'ottimo caratteristiche di resistenza meccanica, in caso di rottura seguire le seguenti procedure:

1. Rimuovere il provvisorio, utilizzare preferibilmente cemento senza eugenolo. In caso di impiego di cementi contenenti eugenolo, si consideri che tracce o residui di eugenolo possono successivamente creare problemi di inibizione verso composti o altri prodotti soprattutto se a base acrilica.

2. Rimuovere l'ottimo caratteristiche di resistenza meccanica, in caso di rottura seguire le seguenti procedure:

1. Rimuovere il provvisorio, utilizzare preferibilmente cemento senza eugenolo. In caso di impiego di cementi contenenti eugenolo, si consideri

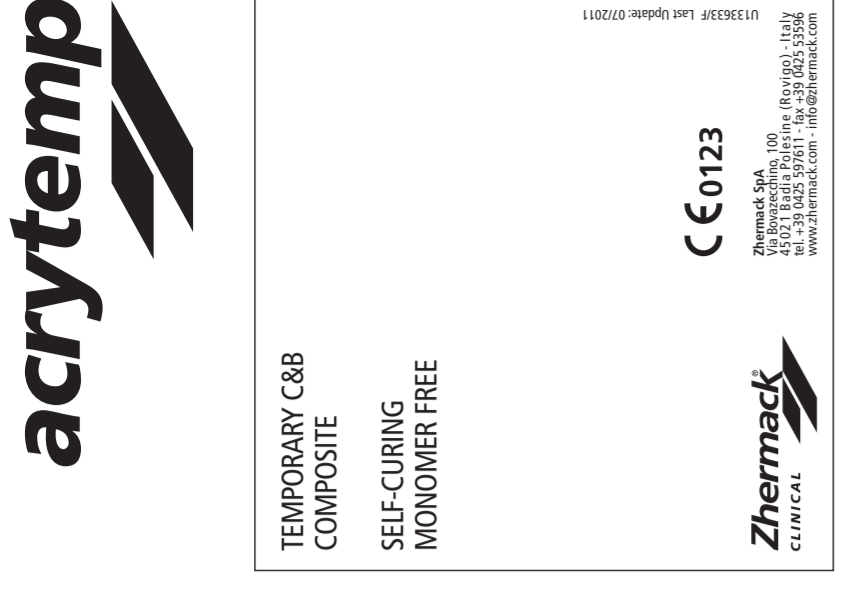

aplikerinnen előford, ha **Acrytemp** láttát bor under den elastiska fázis.

**POZITÍVNYE VEGYÜZŐ**
Néhány másító (de) provizoriok használhatják under den elastiska fázis s át den teie bir skádk.

**HÁRÓDNYOS FÁZIS**
Nem den provizoria lakógörög bir tagis bor frán arányított el preparátionna, s ka da bor elvételre megvárható den eventualis underkérniállás.
Det rekommenderas att eventa polymeriseringen genom att placera modellerna i varmt vatten på 45 °C - 55 °C (113-131°F) cirka 5 minuter. Om det inte är möjligt ska du vänta cirka 10 minuter efter att modellen har blivit färdig med speciella coterende instrument eller mycket fuktiga svampar.
För att värma preparat på ytan och skapar en tunn hinna som gör lätt att ta bort med styllfukt eller annat lösningsmedel.

Andra inte är det stoff som produceras under frisheten. Använd lämpliga skydd (utlug eller skyddsglasögon).

**HÄRNING AV DEN PROVIZORIA LAGNINGEN**
I samband med härtningen av den provizoria lakögörög ska det helvt avsnittet bindemedel som ligger på lämpligt sätt i kontakt med den elastiska fasen. Detta görs genom att använda ett speciellt utrustningsredskap som inte efter rester av detta material kan skapa problem vid härtningen av komponenter och andra produkter i kontakt med den elastiska fasen.

**VIKTIGA ANMÄRKNINGAR**
Beskrivningen av användningen av våra produkter som ges ovanpå, skriftligen eller genom demonstration, baseras på dagens tillgängligt och kända know-how. Den ska betraktas som vägledande information även när det gäller tredje mans eventuella åtgärder. Användaren måste personligen kontrollera om produkten är lämpad för den aktuella tillämpningen. Användningen och tillämpningen av produkten ligger på användarens ansvar då detta sker utan att företaget har möjlighet att utföra en kontroll. Eventuellt ansvar för skador eller begränsat till värdet på den saken svar levereras av företaget och används av användaren.

## acrytemp

Инструкция по применению (RU)

«АКРИТЕМП»
Бисфенольный композитный материал САМОУРЯДОЧЬОНО ПОЛИМЕРИЗУЮЩИЙСЯ

**ОПИСАНИЕ**
Композитная двухкомпонентная паста с твердице в автоматическом состоянии для изготовления временных коронок.

Композитная двухкомпонентная паста с твердице в автоматическом состоянии для изготовления временных коронок.

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОКАЗАНИЯ**

Прямое или непрямое изготовление временных коронок и мостов.
Временные реставрации вкладки и накладок.

**ПРЕИМУЩЕСТВА**
Высокая прочность.
Температура выдерживания при полимеризации – не менее 40°С (104° F), т.е. защищает preparatory область, не создавая неудобств для врача.

Обладает отличными сорбционными качествами, устраняет и высвобождает стабильность реставрации.

Высокие результаты гарантируются бескомпромиссной стабильностью.

При случайной поломке **Acrytemp** легко ремонтируется. Можно использовать только с помощью соответствующего композитного материала для восстановления полной ионической связи.

**СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЯ**
Прямое или непрямое изготовление временных коронок и мостов.
Временные реставрации вкладки и накладок.

**ПРЕИМУЩЕСТВА**
Высокая прочность.
Температура выдерживания при полимеризации – не менее 40°С (104° F), т.е. защищает preparatory область, не создавая неудобств для врача.

Обладает отличными сорбционными качествами, устраняет и высвобождает стабильность реставрации.

Высокие результаты гарантируются бескомпромиссной стабильностью.

При случайной поломке **Acrytemp** легко ремонтируется. Можно использовать только с помощью соответствующего композитного материала для восстановления полной ионической связи.

**СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЯ**
Прямое или непрямое изготовление временных коронок и мостов.
Временные реставрации вкладки и накладок.

**ПРЕИМУЩЕСТВА**
Высокая прочность.
Температура выдерживания при полимеризации – не менее 40°С (104° F), т.е. защищает preparatory область, не создавая неудобств для врача.

Обладает отличными сорбционными качествами, устраняет и высвобождает стабильность реставрации.

Высокие результаты гарантируются бескомпромиссной стабильностью.

При случайной поломке **Acrytemp** легко ремонтируется. Можно использовать только с помощью соответствующего композитного материала для восстановления полной ионической связи.

**СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЯ**
Прямое или непрямое изготовление временных коронок и мостов.
Временные реставрации вкладки и накладок.

**ПРЕИМУЩЕСТВА**
Высокая прочность.
Температура выдерживания при полимеризации – не менее 40°С (104° F), т.е. защищает preparatory область, не создавая неудобств для врача.

Обладает отличными сорбционными качествами, устраняет и высвобождает стабильность реставрации.

Высокие результаты гарантируются бескомпромиссной стабильностью.

## acrytemp

NAVOD K POUŽITÍ (CS)

Biaský polykómpozitní autopolymerizující

**POPIS**
Kompozitní dvoúložková pryskyčice v samostatné složce pro přípravu provizorií.

**SLOŽENÍ**
Multifunkční metakrylové směsi

**MOŽNOSTI POUŽITÍ**
Přímá nebo nepřímá příprava provizorií korunek a můstků. Dosáhně rekonstrukce prvků a náhrad.

**ÚVOD**
Neobsahuje metakrylové typy. Teplota vzhledně během polymerace je nižší než 40°C (104°F), tedy chrání přípravu, aniž by způsobila pacientovi obtíže. Vytváří se optimální prostředí, odolnosti proti úraze a vynikající dimenzionální stabilita.

V případě náhodného pokřžení se dá **Acrytemp** snadno opravit. Po obnovení může být materiál znovu použit jakožto kompozit autopolymerizující nebo fotopolymerizující materiál.

**Acrytemp** je přesný a umožňuje dlouhé užitky obřků.
Pro svou pružnost jsou směsi s dlouhým nasiknem obzvláště odolné.

## ZPŮSOB POUŽITÍ

System ve výrobě používá optimální nasiknem bez bublin, což pomáhá vyhnout se nežádoucímu přetížení otisků (přímá metoda) nebo na masku (nepřímá metoda).

## ODEBRÁNÍ OTISKU

Před přípravou pahýlu odeberte otisk z materiálu silikonu nebo alginátu. Pomocí otiskové formy (např. Putty Cup) vyjměte interdentální zuby a případné spodní záskyby (pokud jsou vhodné) otisk do ústní dutiny. U zadržích kvadrantů v případě nepřítomnosti jednoho zubu vytvořte v otisku drážku tak, abyste mže vždy vytvořit „přemětnou“.

Pro provádění běžné procedury v ordinaci (příprava pahýlu, extrakce atd.)...
V případě, že používáte nepřímou metodu, vypracujte model, což může být činitelem obtíže.

**NÁDOVKOVÁ AUTOMATICKY VYDÁVÁNÍJÍ OBSAH A VLOŽKA**
Pro účely odměrného a vyhodnocení, každá vložka obsahuje množství uvedené pod obrázkem.

Zvedněte zablokovaný výstředník. Umístěte správnou dočku o nádobky (pomeřtí měření je 4:1). Pokud bylo vazené provedeno správně, musí umožnit zavazování zablokovaný vzhled.

Odstráňte bariéry vzduchu. Pro správnou kontrolu tyto vylučte lehce minimální množství vzduchu, dokud obě složky nevystoupí stejnoměrně. Vyčištěním odstraněte vzduch.

**DŮLEŽITÉ ZMĚNY:**
Běha odlehčeno pŕozití nálech výrobků ušlechtných ušlechtných, písmeně nebo nápisem předvedením se vzhledem k otiskování stáží techniky a ná know-how. Musí být považována za nezaujatou informaci. A to i co se týká eventuálních právních věřích osob, a neoprotivě ušlechtných provedení kontrol z vlastní strany za účelem ověření vhodnosti výroby předpokládajícího klienta. K použití a aplikaci je třeba striktně dodržovat každé možnosti kontrol ze strany firmy, a proto být odpovědní ušlechtných. Eventuální odpovědnost za škodu je zastáváno na kvalitě zboží dodaného firmou a ušlechtných ušlechtných.

## acrytemp

MODALITATE DE FOLOSIRE (RO)

Compus biacrilic autopolimerizabil

**DESCRIERE:**
Rajina biokomponent în cartuș cu automezclare pentru protezarea provizorie.

**COMPOZITIE:**
Ester metacrilic, bifunkțional

**UTILIZARE (INDICAȚII):**
Directă sau indirectă a coronoarelor și punțiilor temporare. Restaurări prin inlay și onlay temporare.

**ANVANDNING:**
Nepå direkt eller indirekt a coronoare og punjioner temporare. Restaurering prin inlay og onlay temporare.

**INSTRUKȚIUNI PENTRU UTILIZARE**
Sistemul în cartuș permite o automezclare optimă și fără bule, permițând profesionaliștii să aplice produsul direct în amprentă (metoda directă) sau pe mască metodic indirectă.

**INREGISTRAREA AMPRENTEI**
Înainte de prepararea barierei, țineți o amprentă în silikon sau alginat. Cu un instrument cu țigă (de ex. Putty Cup) eliminați toate interdentare și eventuale suprafețe inclinate, astfel încât să puteți realiza o bună amprentă în cavitatea în care trebuie să fie aplicat otiskul în timpul finisării. Utilizați protecția adecvată (un aspirator de praf sau o mască de protecție).

**CIMENTAREA PROVIZORIA**
Pro cematarii provizoriei utilizațipele poate cauza mernent ce este uzat. În viadul utilizării, trebuie să evitați aplicarea în zona din jurul protezării.

**PREPARAREA LUCRĂRII PROVIZORII**
Acrytemp se aplică ca o lingură până la Acrytemp, este apoi reponiționată corect în gura sau pe mască.

**REPARAREA**
În cazul unei deteriorări, este posibil să fie necesară o reparație. Dacă este posibil, utilizați Acrytemp pentru sterilizarea lichidului utilizat (Zeta 3 (Zhermack)).

**CONDIȚII DE PĂSTRARE, DEPOZITARE ȘI TRANSPORT**
Produsul va fi păstrat la o temperatură între 2°C (35°F) și 20°C (68°F). Se recomandă păstrarea la răcoarea și uscat (de ex. în frigider). Dacă este păstrat în frigider, lăsați produsul la temperatura ambianță cel puțin o oră (1h) înainte de a-l utiliza. Produsul are o valabilitate de 24 luni de la data fabricării dacă este păstrat în condiții optime. Nu utilizați Acrytemp după data expirării.

**CONȚINUTUL ȘI DEZINFECTAREA DISPENSERULUI**
Curățați instrumentele fabricantului la curățarea, dezinfectarea sau sterilizarea la temperatură recomandată de producător. Pentru dezinfectare se recomandă utilizarea a **Zeta 3 (Zhermack)** pentru sterilizarea lichidului utilizat (Zeta 3 (Zhermack)).

**PRIZA ȘI FINISAREA**
După inițierea lucrării provizorii din amprentă sau de preparate, eliminați excesul de material. Este bine să completați polymerizarea prin inserarea produsului în apă caldă la temperatura de 45-55 °C (113-131°F) timp de 5 minute, dacă nu este posibil, așteptați până să se întărească 10 minute de la începutul aplicării și apoi finisați cu instrumente rotative specifice sau foarte fine abrazive.

**NOTĂ IMPORTANTĂ:**
Origenui rezoluție este suprafață în film subțire ce poate fi înlăturat ușor cu alcool etilic sau altoli solvent.

Ha ez nem lehetetés, várjon 10 perccel a felhasználás előtt. Használjon megfelelő védelemmel a szemétől és a légzéstől.
10 minútes várakozás után használja a készítményt az alkalmazott eszközökkel.

**CIMENTAREA LUCRĂRII PROVIZORII:**
Un ciment fără lucșuri este prevăzut a fi utilizat pentru cimentarea lucrării provizorii. Dacă se folosește ciment ce conține eugenol, gândiți-vă că orice rezidu sau urmă de material rămas poate cauza ulterior probleme de inhibare a rezidului aprodus, în special a produselor pe bază de acrilat.

**REPARAREA**
În cazul apariției unor fisuri în zona rezistenței mecanice exceleante a materialului, reparați după caz urmează:

- Fractura apare imediat după prepararea

- În timpul aplicării la produs în timpul finisării. Utilizați protecția adecvată (un aspirator de praf sau o mască de protecție).

- Fractura unei lucrări provizorii existente, utilizați Acrytemp și aplicați suprafața de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice.

**REPARAREA**
În cazul apariției unor fisuri în zona rezistenței mecanice exceleante a materialului, reparați după caz urmează:

- Fractura apare imediat după prepararea

- În timpul aplicării la produs în timpul finisării. Utilizați protecția adecvată (un aspirator de praf sau o mască de protecție).

- Fractura unei lucrări provizorii existente, utilizați Acrytemp și aplicați suprafața de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice.

**REPARAREA**
În cazul apariției unor fisuri în zona rezistenței mecanice exceleante a materialului, reparați după caz urmează:

- Fractura apare imediat după prepararea

- În timpul aplicării la produs în timpul finisării. Utilizați protecția adecvată (un aspirator de praf sau o mască de protecție).

- Fractura unei lucrări provizorii existente, utilizați Acrytemp și aplicați suprafața de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice.

**REPARAREA**
În cazul apariției unor fisuri în zona rezistenței mecanice exceleante a materialului, reparați după caz urmează:

- Fractura apare imediat după prepararea

- În timpul aplicării la produs în timpul finisării. Utilizați protecția adecvată (un aspirator de praf sau o mască de protecție).

- Fractura unei lucrări provizorii existente, utilizați Acrytemp și aplicați suprafața de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice.

**REPARAREA**
În cazul apariției unor fisuri în zona rezistenței mecanice exceleante a materialului, reparați după caz urmează:

- Fractura apare imediat după prepararea

- În timpul aplicării la produs în timpul finisării. Utilizați protecția adecvată (un aspirator de praf sau o mască de protecție).

- Fractura unei lucrări provizorii existente, utilizați Acrytemp și aplicați suprafața de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice.

**REPARAREA**
În cazul apariției unor fisuri în zona rezistenței mecanice exceleante a materialului, reparați după caz urmează:

- Fractura apare imediat după prepararea

- În timpul aplicării la produs în timpul finisării. Utilizați protecția adecvată (un aspirator de praf sau o mască de protecție).

- Fractura unei lucrări provizorii existente, utilizați Acrytemp și aplicați suprafața de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice.

**REPARAREA**
În cazul apariției unor fisuri în zona rezistenței mecanice exceleante a materialului, reparați după caz urmează:

- Fractura apare imediat după prepararea

- În timpul aplicării la produs în timpul finisării. Utilizați protecția adecvată (un aspirator de praf sau o mască de protecție).

- Fractura unei lucrări provizorii existente, utilizați Acrytemp și aplicați suprafața de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice.

**REPARAREA**
În cazul apariției unor fisuri în zona rezistenței mecanice exceleante a materialului, reparați după caz urmează:

- Fractura apare imediat după prepararea

- În timpul aplicării la produs în timpul finisării. Utilizați protecția adecvată (un aspirator de praf sau o mască de protecție).

- Fractura unei lucrări provizorii existente, utilizați Acrytemp și aplicați suprafața de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice.

**REPARAREA**
În cazul apariției unor fisuri în zona rezistenței mecanice exceleante a materialului, reparați după caz urmează:

- Fractura apare imediat după prepararea

- În timpul aplicării la produs în timpul finisării. Utilizați protecția adecvată (un aspirator de praf sau o mască de protecție).

- Fractura unei lucrări provizorii existente, utilizați Acrytemp și aplicați suprafața de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice.

**REPARAREA**
În cazul apariției unor fisuri în zona rezistenței mecanice exceleante a materialului, reparați după caz urmează:

- Fractura apare imediat după prepararea

- În timpul aplicării la produs în timpul finisării. Utilizați protecția adecvată (un aspirator de praf sau o mască de protecție).

- Fractura unei lucrări provizorii existente, utilizați Acrytemp și aplicați suprafața de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice. Apoi curățați și faceți protecția de fractură mai rugoasă și creați rețenții mecanice.

## acrytemp

Třápkompozitní akryřovřnř jřpřpolymerizace

**BEŠKRIVNĚ**
Třápkompozitnř kompozitnř i ampuľi med automatickř bľandřnř fřizivřnřho provizoria lakogřrř.

**SAHMANNSTÄTTNING**
Multifunktionell metakrylerester

**ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER OCH INSTRUKTIONER**
För att rengöra, desinficera eller sterilisera apparaten medelst kalltvatten eller autoklavering efter användningen av materialet. För att rengöra apparaten använd Zeta 3 (Zhermack) för desinficering och Zeta 2 (Zhermack) för sterilisering.

**FÖREBLÅD**
För att rengöra apparaten använd Zeta 3 (Zhermack) för desinficering och Zeta 2 (Zhermack) för sterilisering.

**ANVÄNDNING**
Apparatens tillåter en optimal automatisk blandning utan bubblor som gör att användaren kan applicera produkt direkt på avtrycket (direkt metod) eller på masken (indirekt metod).

**UTRIFÄRDE AV AVTRYCK**
För att rengöra apparaten använd Zeta 3 (Zhermack) för desinficering och Zeta 2 (Zhermack) för sterilisering.

**ANVÄNDNING**
Apparatens tillåter en optimal automatisk blandning utan bubblor som gör att användaren kan applicera produkt direkt på avtrycket (direkt metod) eller på masken (indirekt metod).

**UTRIFÄRDE AV AVTRYCK**
För att rengöra apparaten använd Zeta 3 (Zhermack) för desinficering och Zeta 2 (Zhermack) för sterilisering.

**ANVÄNDNING**
Apparatens tillåter en optimal automatisk blandning utan bubblor som gör att användaren kan applicera produkt direkt på avtrycket (direkt metod) eller på masken (indirekt metod).

**UTRIFÄRDE AV AVTRYCK**
För att rengöra apparaten använd Zeta 3 (Zhermack) för desinficering och Zeta 2 (Zhermack) för sterilisering.

**ANVÄNDNING**
Apparatens tillåter en optimal automatisk blandning utan bubblor som gör att användaren kan applicera produkt direkt på avtrycket (direkt metod) eller på masken (indirekt metod).

**UTRIFÄRDE AV AVTRYCK**
För att rengöra apparaten använd Zeta 3 (Zhermack) för desinficering och Zeta 2 (Zhermack) för sterilisering.

**ANVÄNDNING**
Apparatens tillåter en optimal automatisk blandning utan bubblor som gör att användaren kan applicera produkt direkt på avtrycket (direkt metod) eller på masken (indirekt metod).

**UTRIFÄRDE AV AVTRYCK**
För att rengöra apparaten använd Zeta 3 (Zhermack) för desinficering och Zeta 2 (Zhermack) för sterilisering.

**ANVÄNDNING**
Apparatens tillåter en optimal automatisk blandning utan bubblor som gör att användaren kan applicera produkt direkt på avtrycket (direkt metod) eller på masken (indirekt metod).

**UTRIFÄRDE AV AVTRYCK**
För att rengöra apparaten använd Zeta 3 (Zhermack) för desinficering och Zeta 2 (Zhermack) för sterilisering.

**ANVÄNDNING**
Apparatens tillåter en optimal automatisk blandning utan bubblor som gör att användaren kan applicera produkt direkt på avtrycket (direkt metod) eller på masken (indirekt metod).

**UTRIFÄRDE AV AVTRYCK**
För att rengöra apparaten använd Zeta 3 (Zhermack) för desinficering och Zeta 2 (Zhermack) för sterilisering.

**ANVÄNDNING**
Apparatens tillåter en optimal automatisk blandning utan bubblor som gör att användaren kan applicera produkt direkt på avtrycket (direkt metod) eller på masken (indirekt metod).

**UTRIFÄRDE AV AVTRYCK**
För att rengöra apparaten använd Zeta 3 (Zhermack) för desinficering och Zeta 2 (Zhermack) för sterilisering.

**ANVÄNDNING**
Apparatens tillåter en optimal automatisk blandning utan bubblor som gör att användaren kan applicera produkt direkt på avtrycket (direkt metod) eller på masken (indirekt metod).

**UTRIFÄRDE AV AVTRYCK**
För att rengöra apparaten använd Zeta 3 (Zhermack) för desinficering och Zeta 2 (Zhermack) för sterilisering.

**ANVÄNDNING**
Apparatens tillåter en optimal automatisk blandning utan bubblor som gör att användaren kan applicera produkt direkt på avtrycket (direkt metod) eller på masken (indirekt metod).

**UTRIFÄRDE AV AVTRYCK**
För att rengöra apparaten använd Zeta 3 (Zhermack) för desinficering och Zeta 2 (Zhermack) för sterilisering.

**ANVÄNDNING**
Apparatens tillåter en optimal automatisk blandning utan bubblor som gör att användaren kan applicera produkt direkt på avtrycket (direkt metod) eller på masken (indirekt metod).

**UTRIFÄRDE AV AVTRYCK**
För att rengöra apparaten använd Zeta 3 (Zhermack) för desinficering och Zeta 2 (Zhermack) för sterilisering.

**ANVÄNDNING**
Apparatens tillåter en optimal automatisk blandning utan bubblor som gör att användaren kan applicera produkt direkt på avtrycket (direkt metod) eller på masken (indirekt metod).

**UTRIFÄRDE AV AVTRYCK**
För att rengöra apparaten använd Zeta 3 (Zhermack) för desinficering och Zeta 2 (Zhermack) för sterilisering.

**ANVÄNDNING**
Apparatens tillåter en optimal automatisk blandning utan bubblor som gör att användaren kan applicera produkt direkt på avtrycket (direkt metod) eller på masken (indirekt metod).

**UTRIFÄRDE AV AVTRYCK**
För att rengöra apparaten använd Zeta 3 (Zhermack) för desinficering och Zeta 2 (Zhermack) för sterilisering.

**ANVÄNDNING**
Apparatens tillåter en optimal automatisk blandning utan bubblor som gör att användaren kan applicera produkt direkt på avtrycket (direkt metod) eller på masken (indirekt metod).

**UTRIFÄRDE AV AVTRYCK**
För att rengöra apparaten använd Zeta 3 (Zhermack) för desinficering och Zeta 2 (Zhermack) för sterilisering.

**ANVÄNDNING**
Apparatens tillåter en optimal automatisk blandning utan bubblor som gör att användaren kan applicera produkt direkt på avtrycket (direkt metod) eller på masken (indirekt metod).

**UTRIFÄRDE AV AVTRYCK**
För att rengöra apparaten använd Zeta 3 (Zhermack) för desinficering och Zeta 2 (Zhermack) för sterilisering.

**ANVÄNDNING**
Apparatens tillåter en optimal automatisk blandning utan bubblor som gör att användaren kan applicera produkt direkt på avtrycket (direkt metod) eller på masken (indirekt metod).

**UTRIFÄRDE AV AVTRYCK**
För att rengöra apparaten använd Zeta 3 (Zhermack) för desinficering och Zeta 2 (Zhermack) för sterilisering.

**ANVÄNDNING**
Apparatens tillåter en optimal automatisk blandning utan bubblor som gör att användaren kan applicera produkt direkt på avtrycket (direkt metod) eller på masken (indirekt metod).

**UTRIFÄRDE AV AVTRYCK**
För att rengöra apparaten använd Zeta 3 (Zhermack) för desinficering och Zeta 2 (Zhermack) för sterilisering.

**ANVÄNDNING**
Apparatens tillåter en optimal automatisk blandning utan